



# EntericBio



## REVOLUTIONIERUNG

## DER MOLEKULAREN STUHLDIAGNOSTIK

CE IVD

Keine DNA/RNA  
Extraktion

Kein manuelles  
Pipettieren

Ergebnisse nach  
nur 3 Stunden


Hoher  
Durchsatz



## SEROSEP




# WORKFLOW

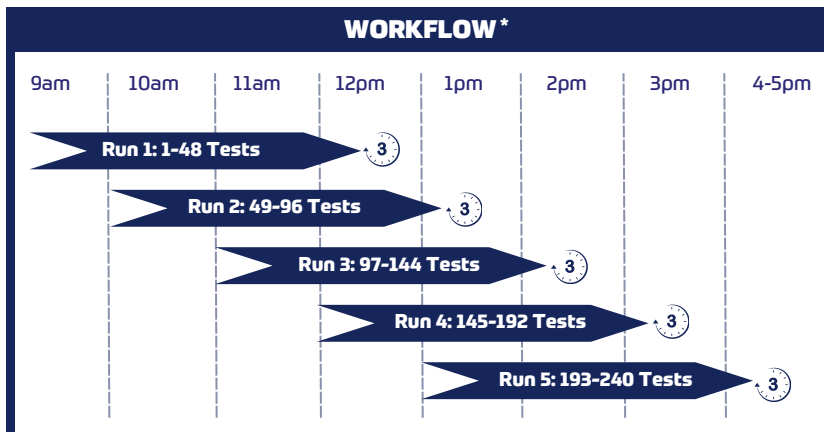

\* Workflow für das EntericBio Dx-Panel bei Verarbeitung von 30 Patientenproben und einer Positiv-/Negativkontrolle

## 4 STUFIGER PROZESS

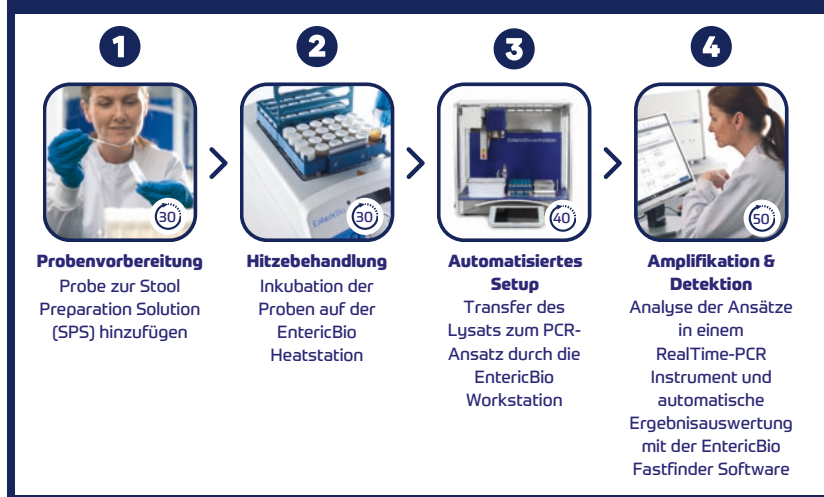

- 1-46 Patientenproben pro Lauf (inkl. +/- Kontrolle)
- Lyophilisierte PCR-Reagenzien
- Weniger als 30 Minuten Hands-on-Time
- Analyse direkt aus der Stuhlsuspension
- Erste Ergebnisse in unter 3 Stunden
- Hoher Durchsatz von bis zu 240 Proben in einer 8-Stunden-Schicht




Annacotty Business Park, Annacotty, Grafschaft Limerick, V94 FF83, Irland  
+353 61 358 190 | info@serosep.com | www.serosep.com

Vertrieben durch: **EUROIMMUN** 


EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG  
Seekamp 31 · 23560 Lübeck (Deutschland)  
Phone +49 451 2032-0 | Fax +49 451 2032-100  
www.euroimmun.com

# PORTFOLIO

## EntericBio® Dx

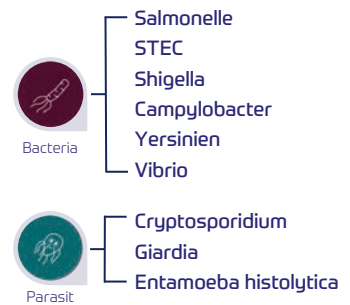


## Viral



## Clostridioides difficile



## CPE\*



\* Probentyp: Stuhlproben oder Rektalabstrich (in flüssigem Medium) und Bakterienisolate

**CE IVD**



Sie wünschen weitere Informationen?  
Scannen Sie hier!